

LENTILLE INTRAOCULAIRE


ARTIS[®] PLE

ACRYLIQUE HYDROPHOBE



Micro-incision

Préchargé

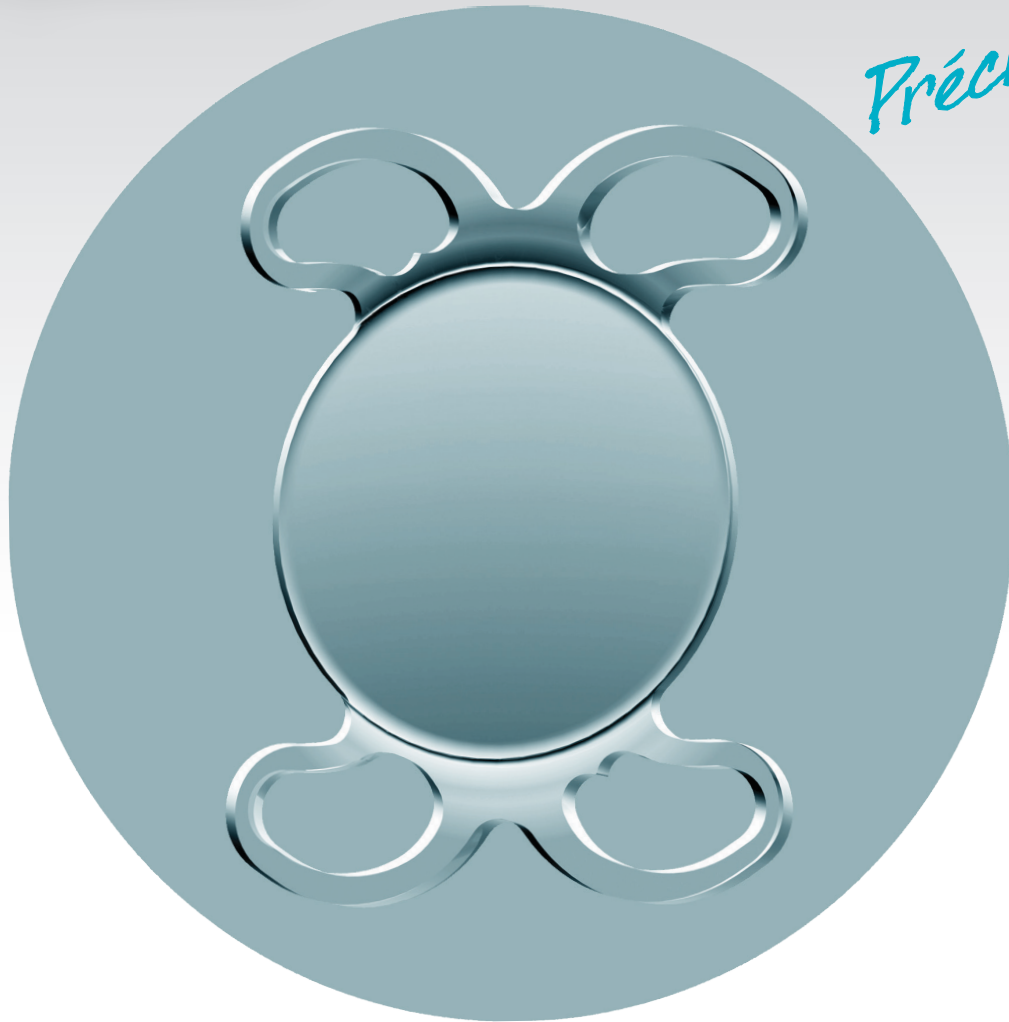

Made in France

CE 0459


Chirurgie
Ophtalmologique

Cristalens

DÉSIGNATION	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Type de lentille	Pour implantation dans le sac capsulaire
Diamètre optique	6.15 mm (de 0D à +9.5D) 6.00 mm (de +10D à +25D) 5.80 mm (de +25.5D à +35D)
Diamètre total	11.00 mm (de 0D à +9.5D) 10.79 mm (de +10D à +25D) 10.50 mm (de +25.5D à +35D)
Forme	Monobloc à bords carrés sur 360°
Optique	Asphérique sur la surface postérieure Compensation des aberrations de la cornée
Angulation	5°
Matériau	Acrylique Hydrophobe pour micro-incision
Puissances dioptriques	De 0.0D à +35.0D par 0.5D
Constante-A estimée (SRK-T)	119.3 biométrie ultrasons 119.7 biométrie laser interférence
Profondeur estimée de la chambre antérieure (ACD)	5.77 mm biométrie ultrasons 6.03 mm biométrie laser interférence
Indice de réfraction	1.54
Stérilisation	Oxyde d'éthylène
Taille de l'incision conseillée	◁ 2.2 mm ovale

22/04/2014 DOC_10_PHOBE

Chirurgie
Ophtalmologique**Cristalens**12 allée Rosa Luxemburg - BP 50240 Eragny
95615 Cergy Pontoise cedex - France

Tél : + 33 (0) 1 34 32 30 50 - Fax : + 33 (0) 1 34 32 30 60

**Cristalens Industrie**

4 rue Louis de Broglie - 22300 Lannion - France

Tél : + 33 (0) 2 96 48 92 92 - Fax : + 33 (0) 2 96 48 97 87

www.cristalens.fr

Cristalens